

Guía de inicio rápido ESPAÑOL

MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL – BP01




tellihealth
DEVICES

1 Para cargar su dispositivo, conecte un extremo del cable de carga al puerto del dispositivo y el otro extremo al cargador de pared. Enchufe el cargador de pared a la toma de corriente. 3-4 horas son suficientes para cargar su dispositivo.




Conecte el tubo del brazalete al lado izquierdo del dispositivo.

2 Coloque el brazalete alrededor de la parte superior de su brazo izquierdo o derecho de manera que el tubo esté alineado con su dedo medio, apuntando hacia su antebrazo y palma.

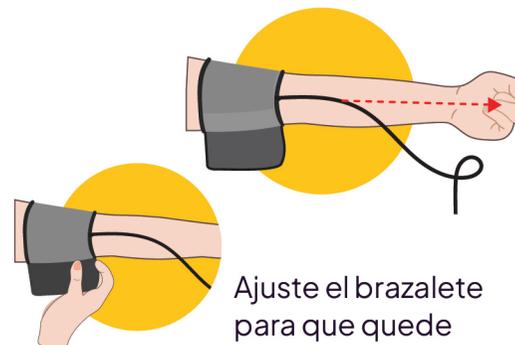


Ajuste el brazalete para que quede firmemente colocado alrededor de su brazo superior.

3 Apoye su brazo (por ejemplo, descansándolo sobre una mesa con una almohada o un libro para ajustar la altura del brazo) de modo que el centro del brazalete esté a la altura del corazón.

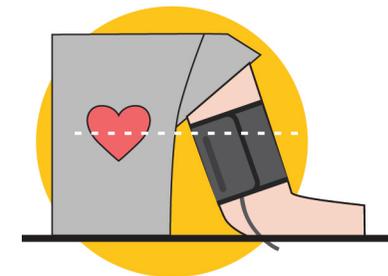

Siéntese cómodamente. Asegúrese de que su espalda esté recta y apoyada. La palma de la mano debe estar hacia arriba.


4 Comience la medición en su dispositivo.

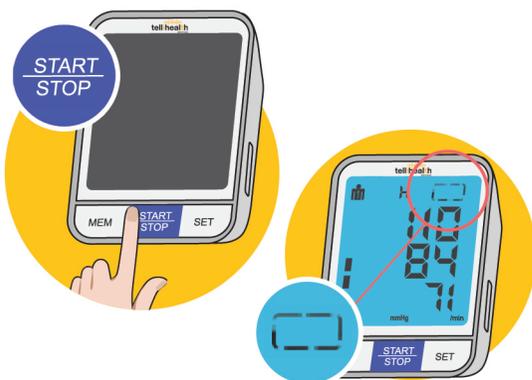

Una vez que obtenga su lectura, aparecerá un rectángulo en su pantalla. Después de que aparezca el rectángulo, puede quitarse el brazalete.

5 Espere hasta que su dispositivo muestre "End" y se apagará automáticamente*.


*El dispositivo puede tardar varios minutos en conectarse a la red celular y completar la transmisión.

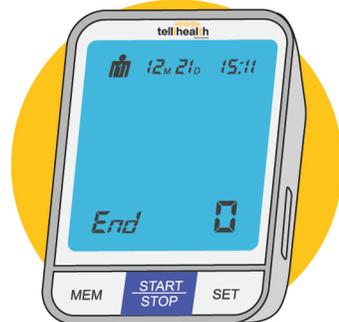

¡HA TERMINADO!

ALERTA DE RECORDATORIO:

A veces, la pantalla del dispositivo parpadeará en color naranja para recordarle que debe tomar una lectura.

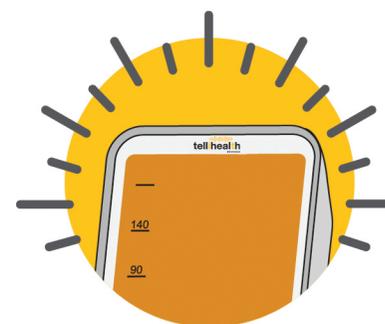

Para detener el recordatorio, por favor, realice una lectura de presión arterial de manera normal.

SILENCIAR RECORDATORIO:

El usuario puede silenciar temporalmente el recordatorio presionando las teclas SET y MEM al mismo tiempo.

